

# 检测报告

## TEST REPORT

产品名称

NAME OF SAMPLE

壳体、压力接头

商标型号

TRADE MARK & TYPE

XB2288 壳体、3351 壳体、3352 壳体、压力接头

制造厂商

MANUFACTURER

广州森纳士仪器有限公司

委托单位

CLIENT

广州森纳士仪器有限公司

检验类别

TEST SORT

委托试验

检验项目

TEST ITEM

醋酸盐雾测试

## 深圳亿博测试中心

### SHENZHEN EBO TESTING CENTER

地址: 深圳市福田区深南路竹子林益华大厦北 710

邮政编码/P.C.: 518010

Address: North 710, Yihua Building, Shennan Road, Futian District, Shenzhen, 518040, P. R. China.


电话/TEL: 0755-29451282

传真/FAX: 0755-22639141

网址/Internet: <http://www.ebotek.cn>

电子信箱/E-Mail: [ebo@ebotek.cn](mailto:ebo@ebotek.cn)

**深圳亿博测试中心**  
SHENZHEN EBO TESTING CENTER  
**检测报告**  
TEST REPORT

样品名称	壳体、压力接头		商 标	----	
制造厂商	广州森纳士仪器有限公司		型号规格	XB2288 壳体、3351 壳体、3352 壳体、压力接头	
委托单位	广州森纳士仪器有限公司		取样方式	生产厂送样	
抽样单位	----		抽样母数	----	
抽样地点	----		抽样数量	4pcs	
生产日期	----	抽样日期	----	送检日期	2011 年 7 月 19 日
检验日期	2011 年 7 月 25 日~2011 年 7 月 29 日		检验环境	15~35℃ 45~75%RH	
<p>样品说明:</p> <p>试验样品 4pcs, 编号:</p> <p>1# -XB2288 壳体: 重量: 571g;</p> <p>2# -3351 壳体, 重量: 769.5g;</p> <p>3# -3352 壳体, 重量: 757.1g;</p> <p>4# -压力接头重量: 93.1g。</p> <p>试验前样品外观完好。</p>					
<p>检验项目(Test item):</p> <p>醋酸盐雾试验</p>					
<p>检测依据(Reference documents):</p> <p>企业技术要求</p>					
<p>检验概况(Summary):</p> <p>依据企业技术要求对样品进行了醋酸盐雾试验, 检测结果见附页数据。</p>					
<p>检验结论(Test conclusion):</p> <p>检测项目和检测结果见附页数据。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验单位盖章 stamp)</p> </div>					
检 测:	<i>SmartLi</i>	审 核:	<i>Soleng Lu</i>	批 准:	<i>Caijv</i>
Tested by		Inspected by		Approved by	
	2011 年 8 月 1 日		2011 年 8 月 1 日		2011 年 8 月 1 日
	Y M D		Y M D		Y M D

## 测试结果

样品编号	试验标准和条件	检测项目	技术要求	试验后样品重量	检验结果
1# -XB2288	试验温度: $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 氯化钠溶液浓度: $50\text{g/L} \pm 5\text{g/L}$ PH 值: $3 \pm 0.3$ 盐雾沉降量: $1-2\text{mL}/80\text{cm}^2/\text{h}$ 样品放置方式: 与垂直 面约 $15^{\circ} - 30^{\circ}$ 持续时间: 100H	外观	试验后不允许出现点蚀, 生锈, 裂纹, 气泡等现象	571.7g	试验 35h 后, 样品表面出现黑斑现象。
2# -3351				769.4g	试验 25h 后, 样品螺纹边出现黑斑现象; 试验 94h 后, 样品表面掉漆现象。
3# -3352				762.5g	试验 25h 后, 样品螺纹边出现黑斑现象; 试验 90h 后, 样品表面掉漆现象。
4# -压力接头				94.1g	试验 90h 后, 样品表面出现生锈现象。

## 测量用主要仪器


序号	名称	型号	编号
1	盐雾试验机	WHSST-108	201104

注: 以上仪器设备均在计量检定周期内


测试前照片




1#-XB2288

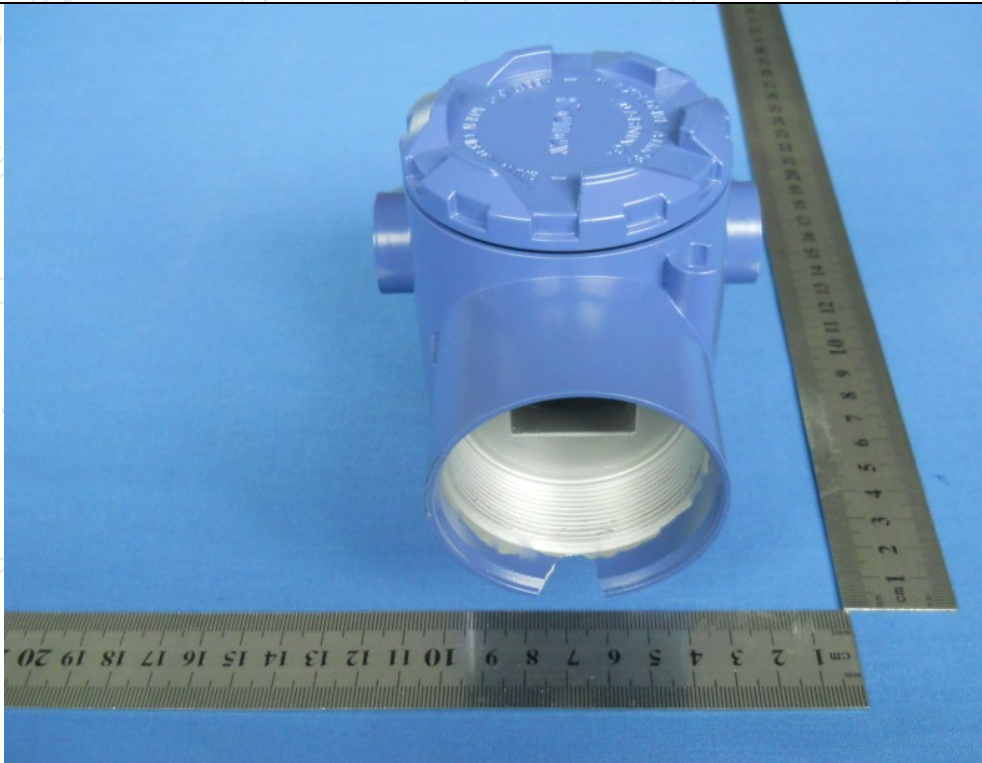

2#-3351

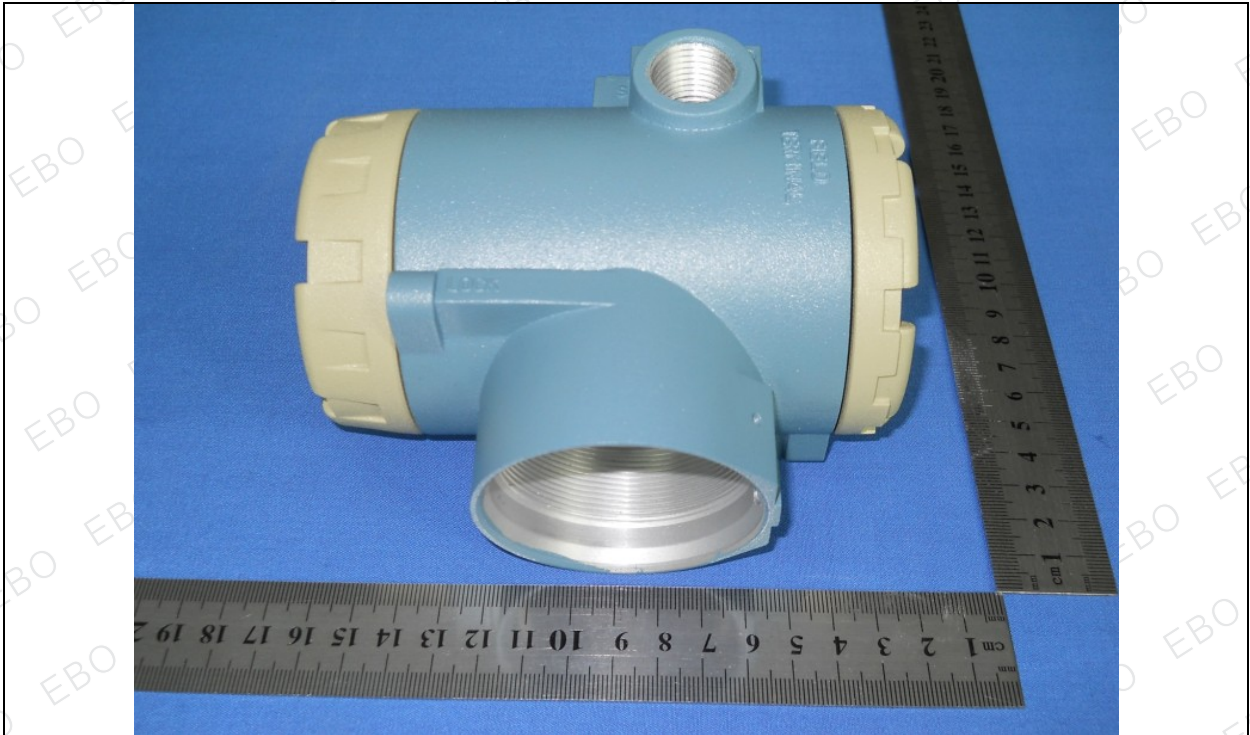

3# -3352

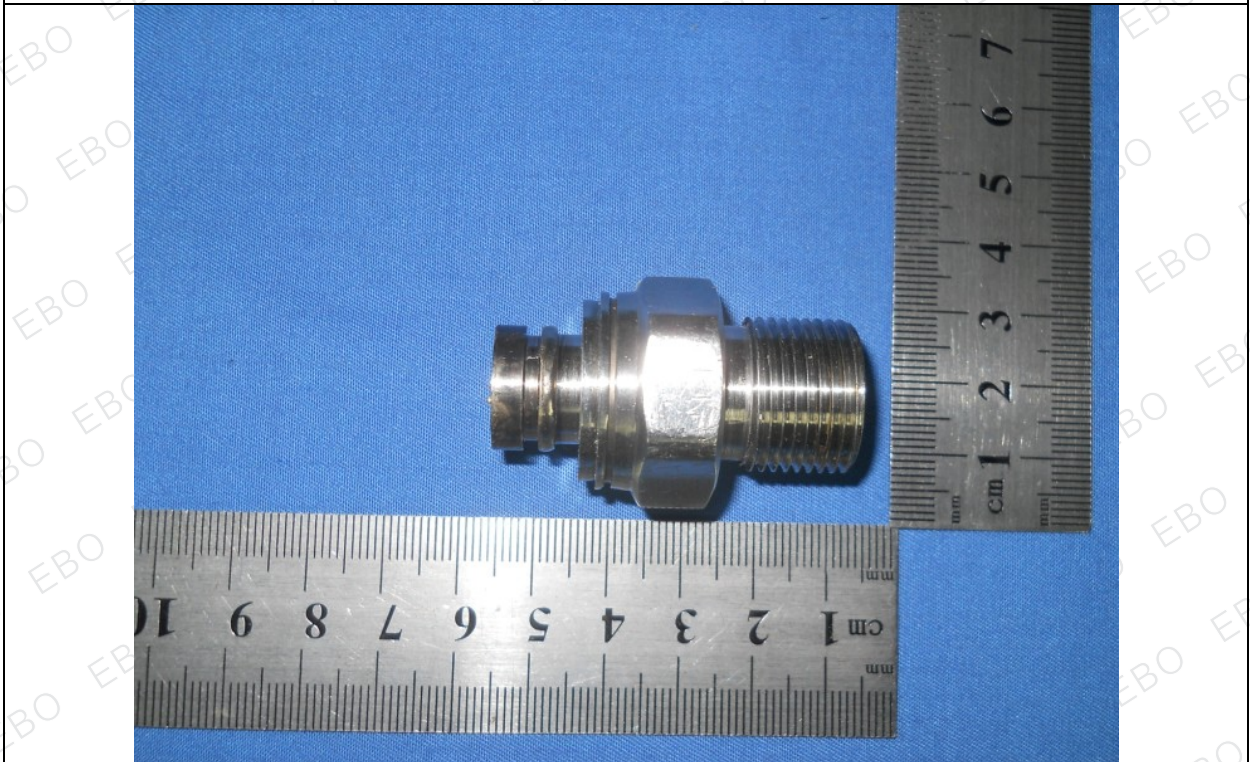

4# -压力接头

测试后照片



1# -XB2288



2# -3351 -1



2# -3351 -2



3# -3352 -1



3# -3352 -2



4# -压力接头



## 声 明

## STATEMENT

**1. 报告未加盖“检测专用章”无效。**

The test report is invalid without stamp of laboratory.

**2. 报告无检测、批准人员签字无效。**

The test report is invalid without signature of person(s) testing and authorizing.

**3. 报告涂改无效。**

The test report is invalid if erased and corrected.

**4. 自送样品的检测结论仅对送检样品有效。**

Test results of the report is valid to the test samples if sampling by client.

**5. 未经本实验室书面同意，不得部分地复制本报告。**

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

**6. 如对本报告有异议，可在收到报告后 15 天内向本单位申诉，逾期不予受理。**

If there is any objection to report, the client should inform issuing laboratory within 15 days from the date of receiving test report.

地 址：深圳市福田区深南路竹子林益华大厦北 710

邮政编码/P.C.: 518010

Address: North 710, Yihua Building, Shennan Road, Futian District, Shenzhen, 518040, P. R. China

电话/TEL: 0755-29451282

传真/FAX: 0755-22639141

网址/Internet: <http://www.ebotech.cn>

电子信箱/E-Mail: [ebo@ebotech.cn](mailto:ebo@ebotech.cn)